

CONCORDANCIA Y VARIABILIDAD EN LA MEDICIÓN DE GLUCEMIA CAPILAR EN ATENCIÓN PRIMARIA




Xavier Bayona Huguet, Raúl Porras Benjumea, Sandra Arco Rodríguez, Jaume Català Coll, Silvia López Marchena, Lorena Martín Callejón



Estudio observacional realizado por Badalona Serveis Assistencials (BSA) que analiza la precisión de tres glucómetros (FreeStyle, Contour y Glucomen) frente a la glucemia venosa en 131 episodios reales para evaluar el sesgo de medida y la seguridad clínica.

Comparativa de Desempeño por Dispositivo

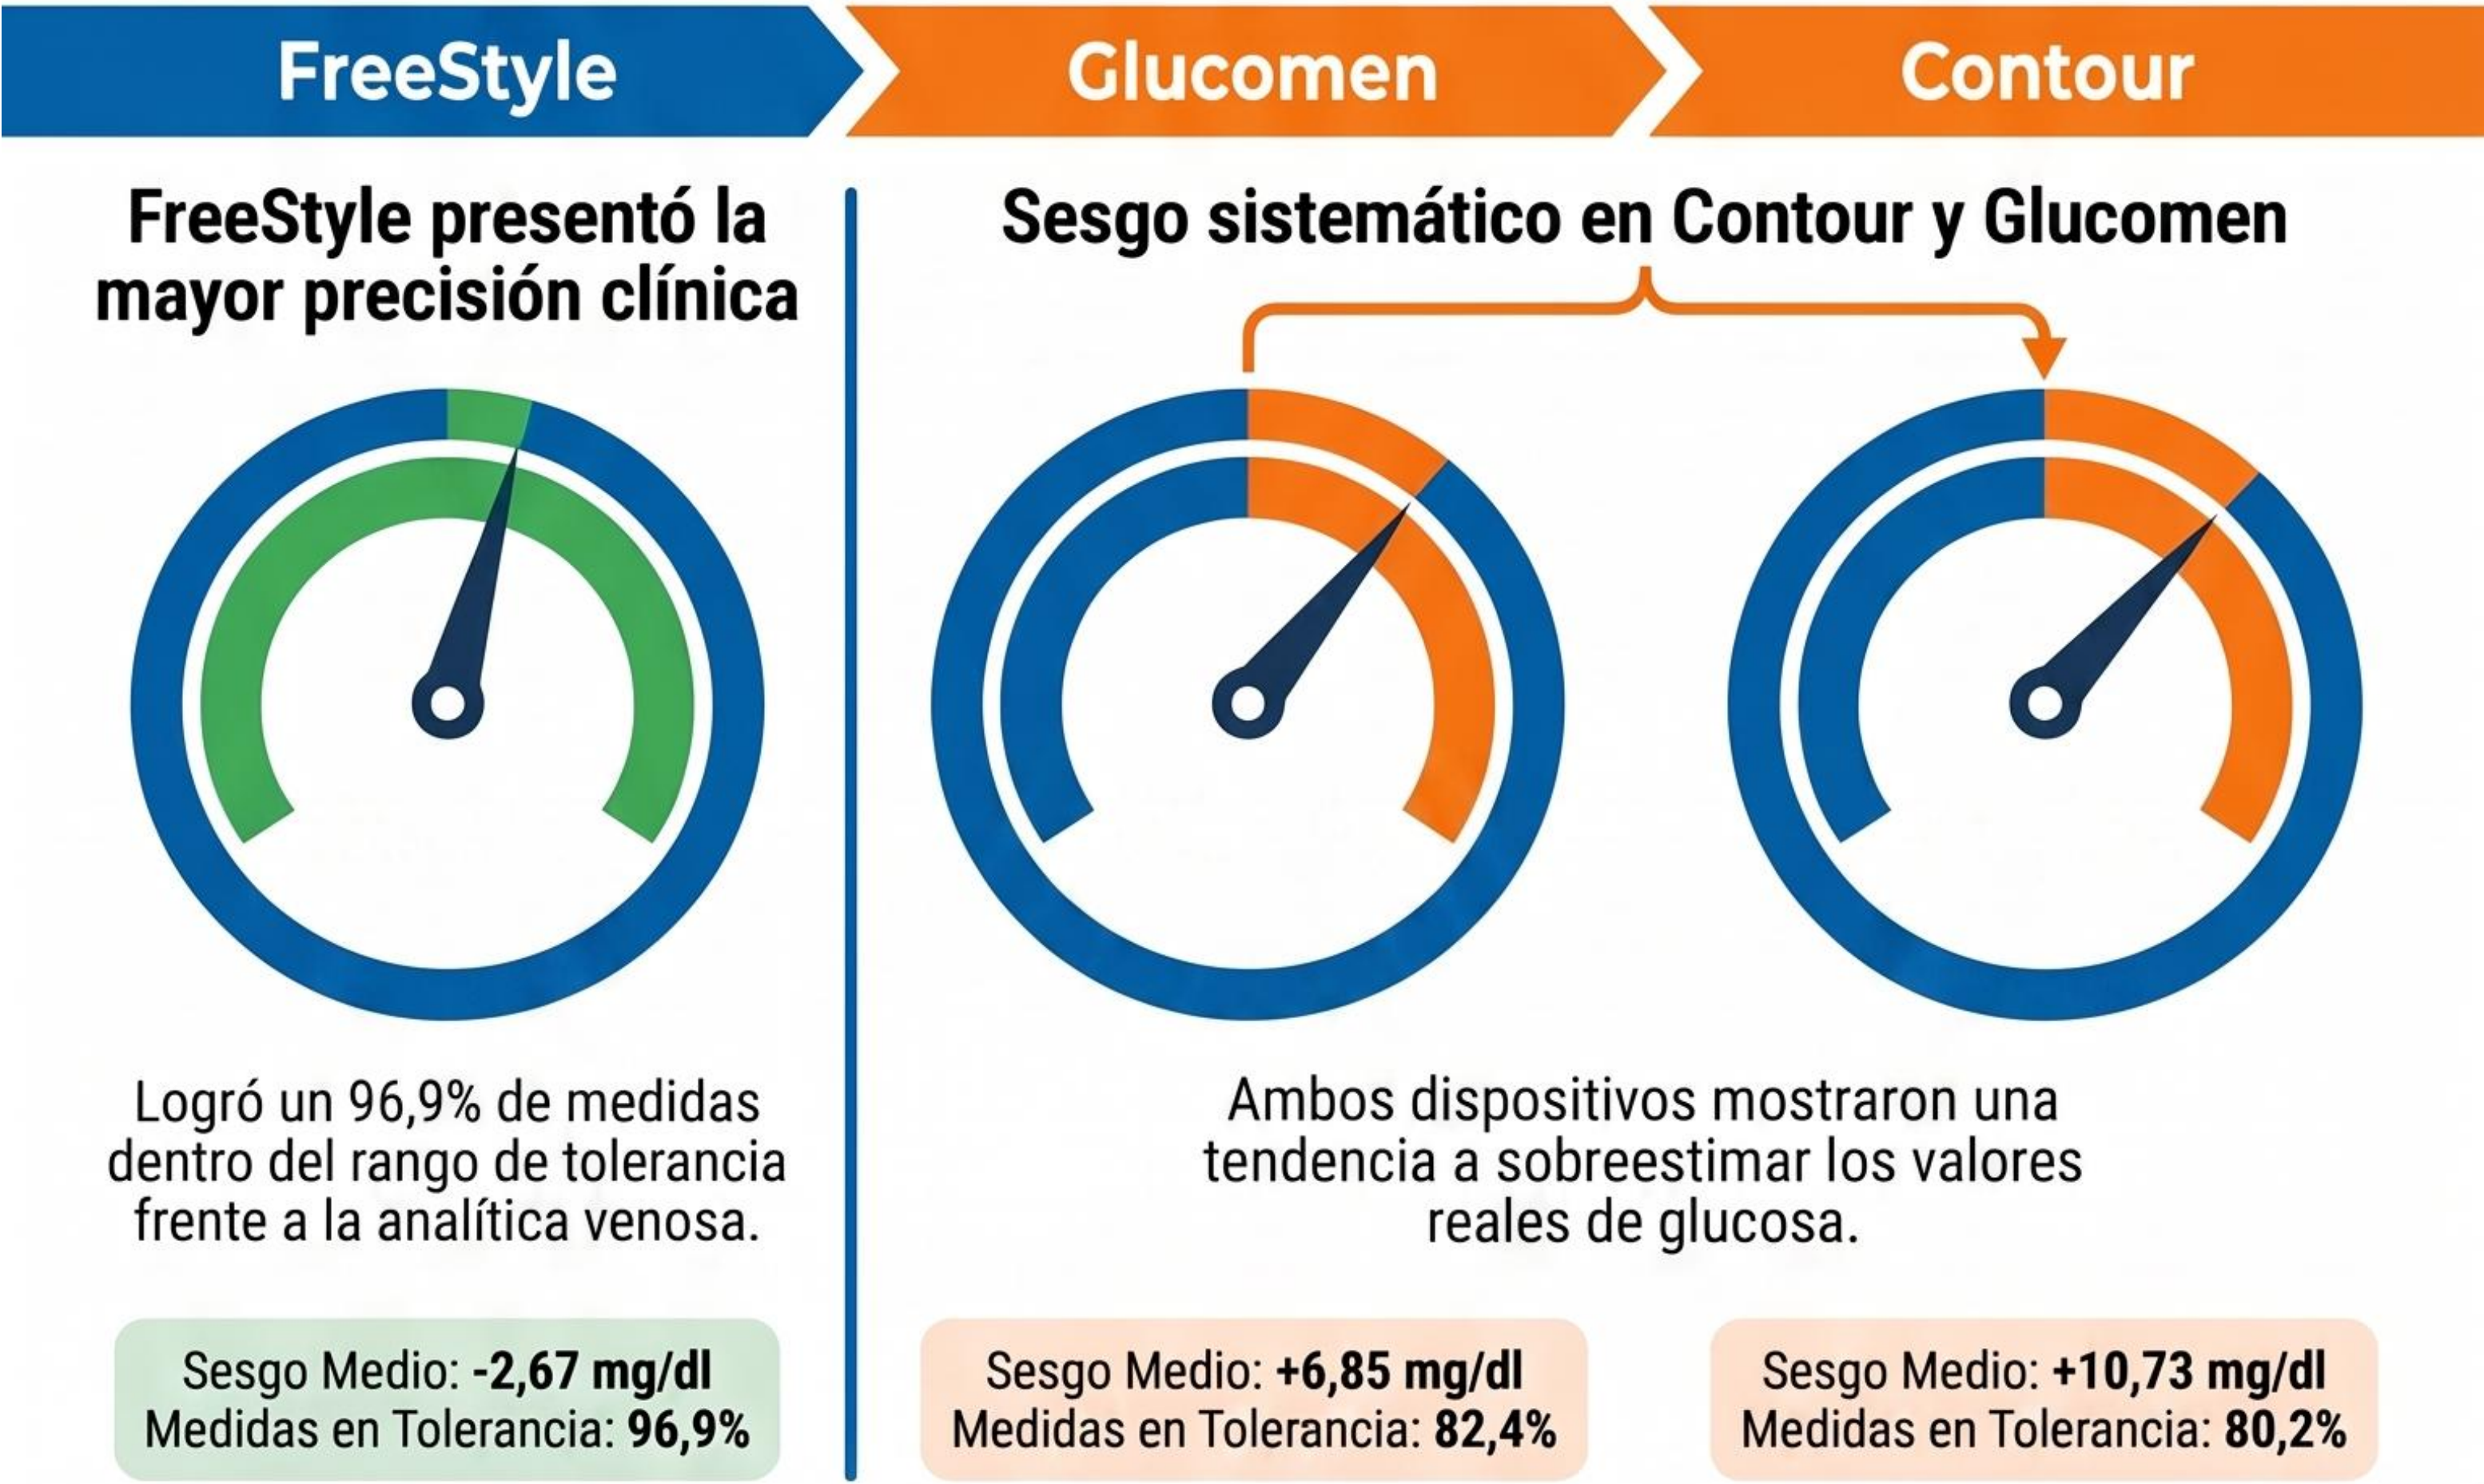

Implicaciones Clínicas y Seguridad

